



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY**

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22,
fax. 370 27 92

e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl

http://www.zsm.czest.pl



Częstochowa, dnia 22.05.2024 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na zakup i dostawa kabli, czujników, mankietów dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Pytanie 1

Pakiet 5 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 2

Pakiet 6 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanej rurki.

Odpowiedź: Nr katalogowy rurki do mankietu firmy Draeger, - MP00953

Pytanie 3

Pakiet 6 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Nr katalogowy czujnika SPO2 firmy Draeger, - MP00796

Pytanie 4

Pakiet 6 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego adaptera.

Odpowiedź: Nr katalogowy adaptera firmy Draeger, - 336843

Pytanie 5

Pakiet 7 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiary 25-35 cm i 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 6

Pakiet 8 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiary 25-35 cm i 33-47 cm ? Reszta bez zmian.


Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 7

Pakiet 8 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Nr REF czujnika Spo2 – PK GD89x-38/L-300

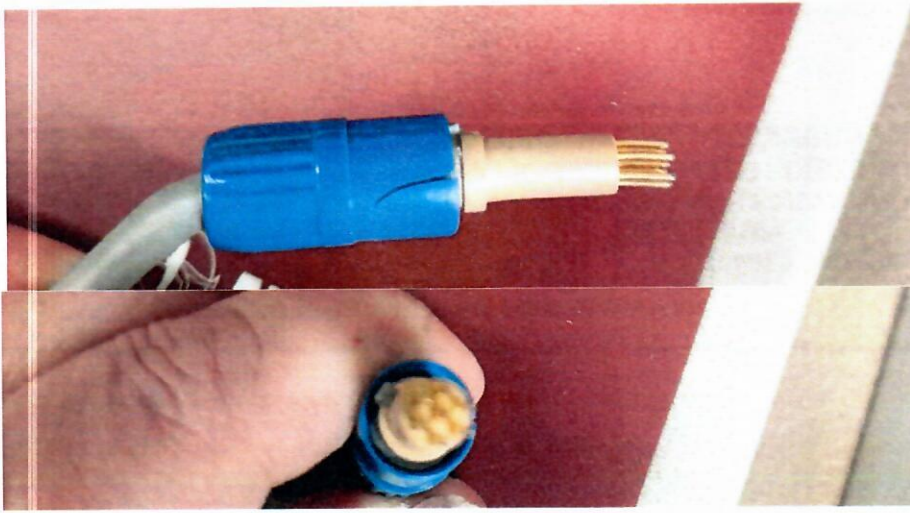

Pytanie 8

Pakiet 9 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiary 25-35 cm i 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 9

Pakiet 10 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiary 25-35 cm i 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 10

Pakiet 11 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiary 25-35 cm i 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 11

Pakiet 13 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o kabel kompletny czy rozłączny ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kabla kompletnego.

Pytanie 12

Pakiet 13 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji ile ma mieć odprowadzeń kabel EKG ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga kabla z 3 odprowadzeniami.

Pytanie 13

Pakiet 13 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego adaptera.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż numer kat. obecnie używanego adaptera z firmy LM Line MQ3-90P-I

Pytanie 14

Pakiet 13 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż numer kat. Obecnie używanego kabla z firmy LM Line U410 121

Pytanie 15

Pakiet 15 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości kabla. 1 metr czy 3 metry ?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga kabla 3 metry

Pytanie 16

Pakiet 16 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zdjęcia poglądowe obecnie używanego kabla, brak numerów REF do odczytu.

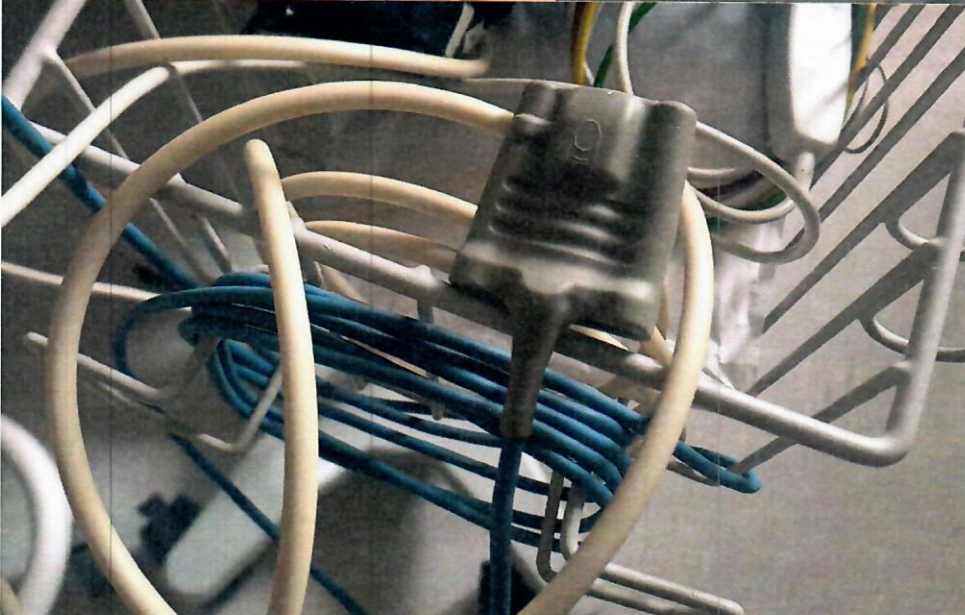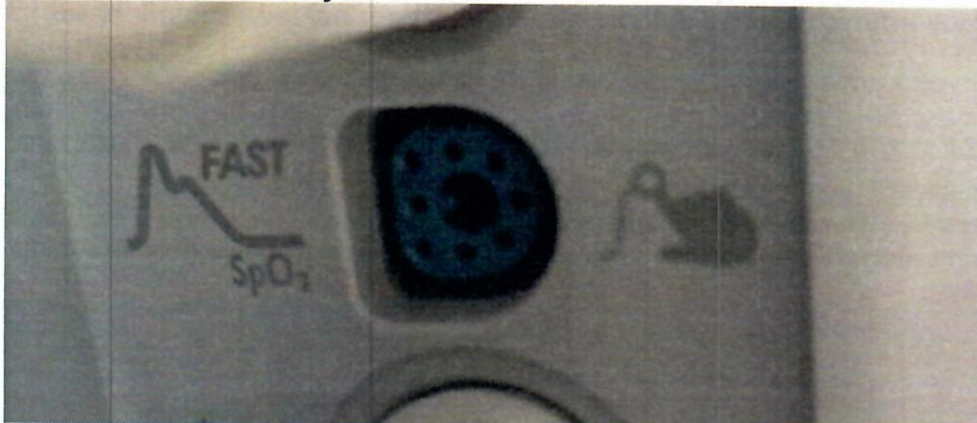

Pytanie 17

Pakiet 19 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego adaptera.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o braku możliwości odczytu nr REF obecnie używanego adaptera. Adapter musi być kompatybilny z wskazanymi kardiomonitorami i czujnikiem. Na aktualnym wyposażeniu Zamawiający posiada czujnik nr ref DOC10CE123

Pytanie 18

Pakiet 19 Pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na aktualnym wyposażeniu posiada czujnik nr ref DOC10CE123

Pytanie 19

Pakiet 26 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zdjęcia poglądowe obecnie używanego czujnika, brak numerów REF do odczytu

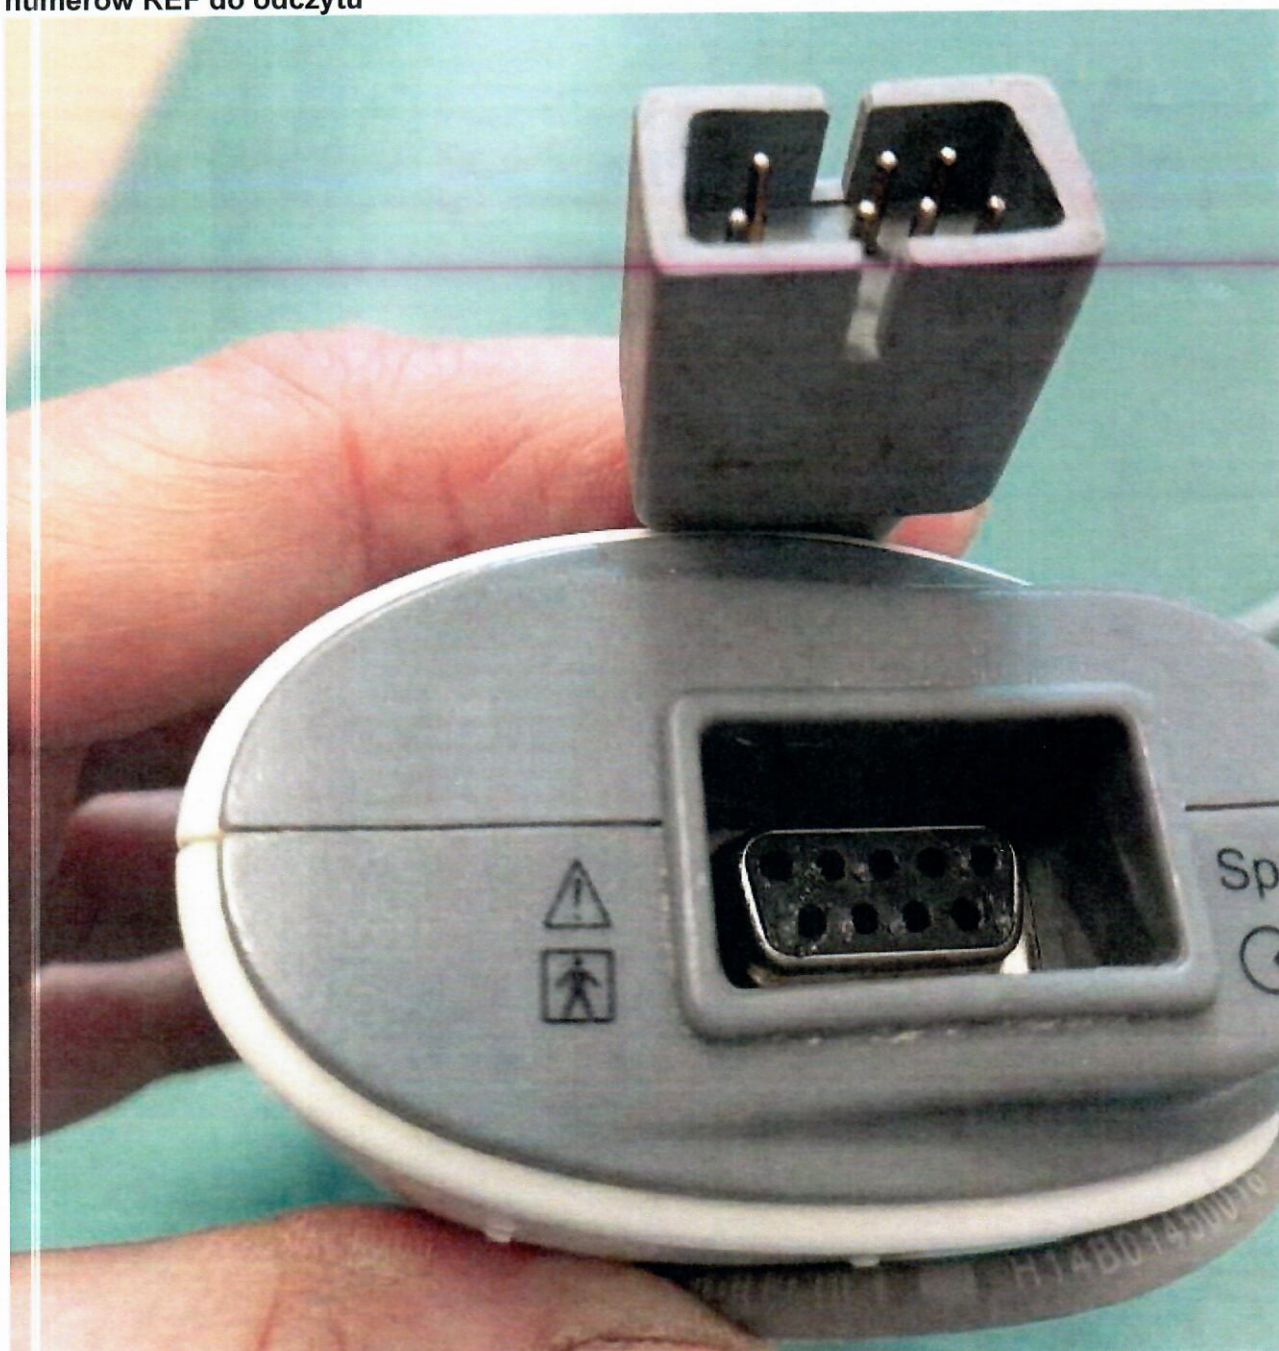

Pytanie 20

Pakiet 27 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na aktualnym wyposażeniu posiada czujnik nr ref DS-100A

Pytanie 21

Pakiet 30 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy czujnik ma być dla dorosłych czy dla noworodków? Numery katalogowe na zdjęciach są różne.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o ofertę na obydwa czujniki, do wyboru Zamawiającego zgodnie z zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Pytanie 22

Pakiet 33 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o nastąpieniu omyłki w opisie pakietu.

Pytanie 23

Pakiet 34 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji ile ma mieć odprowadzeń kabel EKG ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga kabla 7 odprowadzeniowego.

Pytanie 24

Pakiet 39 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie używany jest nr REF 900IW001.

Pytanie 25

Pakiet 40 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o nastąpieniu omyłki w opisie pakietu.

Pytanie 26

Pakiet 41 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o nastąpieniu omyłki w opisie pakietu.

Pytanie 27

Dotyczy pakietu nr 5: P5 – Kariom., pkt 3

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne mankiety producenta kardiomonitorów o rozmiarach 23-33cm oraz 33-45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu nr 5: P5 – Kariom., pkt 6

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny adapter do SpO2 producenta kardiomonitorów o długości 2,5m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 29

do pakietu 29

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki rodzaj czujnika zamawiający wymaga: typu klips na palec dla dorosłych >30kg; typu klips na palec dla pediatryczny 10-50kg; gumowy na palec >30kg; klips na ucho dla dorosłych, czujnik typu Y >1kg.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o uwzględnienie w ofercie czujnika typu klips na palec pediatryczny 10-50 kg oraz czujnika typu Y >1 kg do wyboru przez Zamawiającego.

Pytanie 30

do pakietu 29

Czy Zamawiający wymaga samego czujnika z połączeniem typu RD w technologii Masimo Set - pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji, czy też odpowiedniego kabla do posiadanego pulsoksymetru?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnika pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji

Pytanie 31

do pakietu 13

Czy Zamawiający wymaga samego kabla EKG czy kabla EKG wraz z odprowadzeniami (kabla pacjenta)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kabla EKG wraz z odprowadzeniami.

Pytanie 32

do pakietu 13

Prosimy o doprecyzowanie jakiego adaptera do jakiego kabla Zamawiający wymaga w poz.2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż numer kat. obecnie używanego adaptera z firmy LM Line MQ3-90P-I

Pytanie 33

do pakietu 13

Prosimy o doprecyzowanie jakiego mankietu wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż numer kat. obecnie używanego mankietu z konektorem z firmy LM Line – U1880D + BP18

Pytanie 34

do pakietu 13

Prosimy o doprecyzowanie w jakiej technologii ma pracować kabel SpO2. Czy Zamawiający wymaga samego kabla czy też czujnika SpO2. Jeśli też czujnika to jakiego rodzaju i dla jakiej grupy pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż numer kat. Obecnie używanego kabla Spo2 z firmy LM Line U410 121

Pytanie 35

Pakiet 5

poz. 6 prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 36

Pakiet 7

poz. 3 prosimy o dopuszczenie rozmiarów 25-35 cm i 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 37

Pakiet 7

poz. 4 prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 38

Pakiet 7

poz. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 0,9 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 39

Pakiet 8

poz. 3 prosimy o dopuszczenie rozmiarów 25-35 cm i 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 40

Pakiet 9

poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 1m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 41

Pakiet 9

poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiarów 25-35 cm i 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 42

Pakiet 10

poz. 1 prosimy o dopuszczenie rozmiarów 25-35 cm i 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 43

Pakiet 10

poz. 2 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 44

Pakiet 11

poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiarów 25-35 cm i 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 45

Pakiet 11

poz. 3 prosimy o dopuszczenie dł. 0,9 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 46

Pakiet 16

poz. 3 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 47

Pakiet 17

poz. 3 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 48

Pakiet 18

poz. 3 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 49

Pakiet 21

poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 3 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 50

Pakiet 23

poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 3 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 51

Pakiet 25

poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 3 m lub 0,9 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również dł. 3m. Odnośnie długości 0,9m zgodnie z SWZ

Pytanie 52

Pakiet 26

poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 3 m lub 0,9 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również dł. 3m. Odnośnie długości 0,9m zgodnie z SWZ

Pytanie 53

Pakiet 28

poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 3 m lub 0,9 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również dł. 3m. Odnośnie długości 0,9m zgodnie z SWZ

Pytanie 54

Pakiet nr 5, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozm. 25-35, 33-47 lub 31-53 cm co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 55

Pakiet nr 6, poz. 1, 2, 4-6: Prosimy o podanie n-rów ref. dotychczas użytkowanych akcesoriów lub udostępnienie zdjęć ich wtyczek.

Odpowiedź: Poz. na 1 – nr katalogowy EKG odpr. firmy Draeger – MS14555,

Poz. 2 – nr katalogowy EKG kab.gł. firmy Draeger – MS20093

Poz. 4 – nr katalogowy rurka d/mank. firmy Draeger – MP00953

Poz. 5 – nr katalogowy czujnika Spo2 firmy Draeger – MP00796

Poz. 6 – nr katalogowy adaptera d/ cz. firmy Draeger - 3368433

Pytanie 56

Pakiet nr 7, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozm. 25-35, 33-47 lub 31-53 cm co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar ciśnienia cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 57

Pakiet nr 7, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści czujnik o dł. 1 m? Różnica w długości wynosząca 10 cm nie wpłynie w żaden sposób na komfort pracy użytkownika, ani jakość pomiaru saturacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 58

Pakiet nr 8, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozm. 25-35, 33-47 lub 31-53 cm co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 59


Pakiet nr 9, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozm. 33-47 lub 31-53 cm co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar ciśnienia?


Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 60

Pakiet nr 9, poz. 3: Prosimy o udostępnienie zdjęć gniazd SpO₂ w kardiomonitorach Mindray uMec12 i Benevision N12 posiadanych przez Zamawiającego. W formularzu cenowym Zamawiający umieścił zdjęcie gniazda w monitorze Mindray MEC 2000, z umieszczonych poniżej wymagań wynika jednak, że Zamawiający wymaga czujników SpO₂ kompatybilnych z 3 modelami kardiomonitorów Mindray (MEC 2000, uMec12 i Benevision N12)

Odpowiedź: Mindray uMEC12

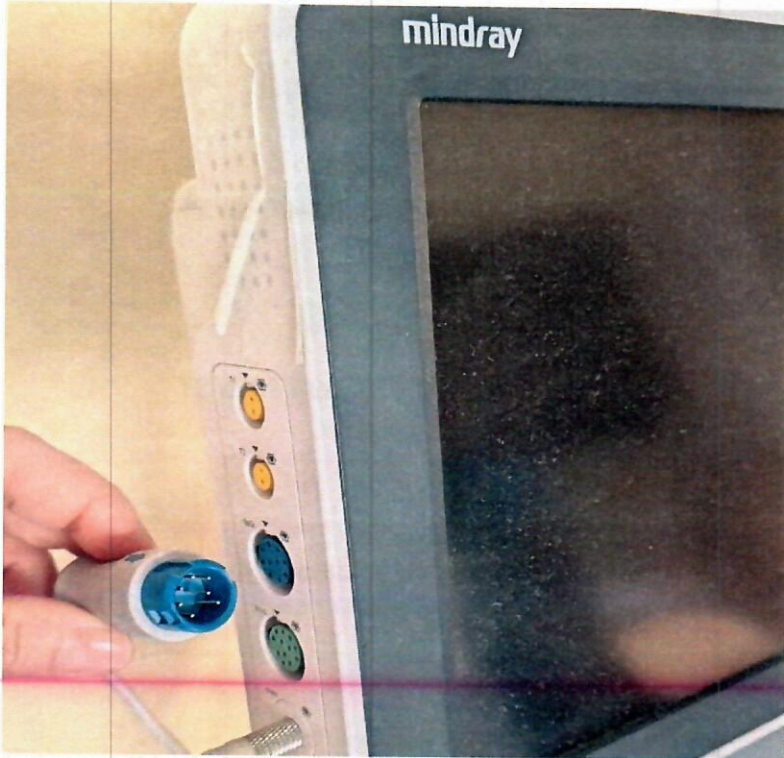

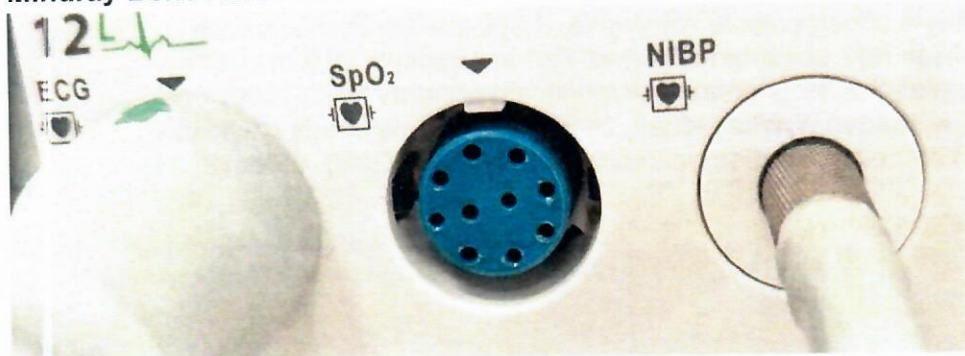

Pytanie 61

Pakiet nr 10, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozm. 25-35, 33-47 lub 31-53 cm co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 62

Pakiet nr 11, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozm. 25-35, 33-47 lub 31-53 cm co nie wpłynie w żaden sposób na dokonywany pomiar ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 63

Pakiet nr 11, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści czujnik o dł. 1 m? Różnica w długości wynosząca 10 cm nie wpłynie w żaden sposób na komfort pracy użytkownika, ani jakość pomiaru saturacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 64

Pakiet nr 21, poz. 1: Prosimy o podanie n-ru ref. obecnie użytkowanego czujnika. Czy Zamawiający dopuści czujnik o dł. 3 m? Dłuższy przewód nie wpłynie w żaden sposób na komfort pracy użytkownika ani jakość pomiaru saturacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 65

Pakiet nr 23, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści czujnik o dł. 3 m? Dłuższy przewód nie wpłynie w żaden sposób na komfort pracy użytkownika ani jakość pomiaru saturacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 66

Pakiet nr 25, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści czujnik o dł. 3 m? Dłuższy przewód nie wpłynie w żaden sposób na komfort pracy użytkownika ani jakość pomiaru saturacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 67

Pakiet nr 26, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści czujnik o dł. 3 m? Dłuższy przewód nie wpłynie w żaden sposób na komfort pracy użytkownika ani jakość pomiaru saturacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 68

Pakiet nr 28, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści czujnik o dł. 3 m? Dłuższy przewód nie wpłynie w żaden sposób na komfort pracy użytkownika ani jakość pomiaru saturacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

p.o. DYREKTOR
Małgorzata Guzik