



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czyst.pl http://www.zsm.czyst.pl



Częstochowa, dnia 11.07.2025 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na zakup i dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego MSZ/WZP/2025/5

Pytanie 1 Pakiet 8


Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny zgodzi się na **dopuszczenie do zaoferowania mankiet do szybkich przetoczeń wg poniższej charakterystyki:**

Wielorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowej o **pojemności 1000ml**.

Mankiet z poliamidu (laminowany termoplastyczny poliuretan)- łatwy w czyszczeniu/dezynfekcji, nie zawiera latexu. Mankiet z przednią transparentną siatką do kontroli poziomu płynów, podwójny haczyk umiejscowiony nad siatką do mocowania płynów różnej pojemności. Czytelny nadruk maksymalnej objętości wkładanego płynu do toczeń na mankiecie. Wydajna gruszka z tójstopniowym zaworem do napełnienia. kontroli ciśnienia i szybkiej deflacji. Czytelny zabezpieczony ciśnieniowo manometr wyskalowany do 300 mm Hg (wyskalowany co 10 mm Hg) umieszczony nad haczykiem. Uchwyt do powieszenia mankietu.

Okres trwałości mankietu do 5 lat od daty produkcji, możliwość dezynfekcji do 100 razy w tym okresie. Gruszka z drenem dostępne jako części zamienne (potwierdzone z karcie katalogowej produktu). Produkt posiada kod UDI- identyfikacja produktu. **Dezynfekcję** przez wycieranie należy wykonywać dostępnymi w handlu środkami do dezynfekcji powierzchniowej na bazie alkoholu, czwartorzędowych związków amonowych lub nadtlenu wodoru. Do dezynfekcji należy wybrać środki dezynfekcyjne o odpowiednim zakresie działania: bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym ?

Zdjęcie poglądowe

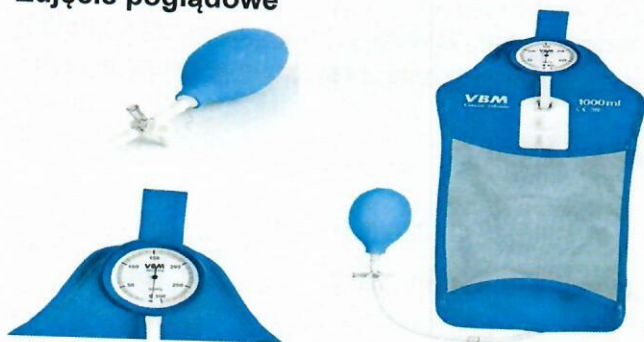

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pytanie 2 Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści poniższe wymiary łyżek:

Rozmiar	Długość [mm]	Szerokość [mm]
Mac 2	116	14
Mac 3	136	14
Mac 4	156	14

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3 pakiet 1, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści resuscytator silikonowy wielorazowego użytku, bez zawartości lateksu, przystosowany do sterylizacji w autoklawie (temp. 134 C) z wyłączeniem rezerwuaru i drenu, wymaga dodatkowej złącznik do podłączenia zastawki PEEP, w zestawie jedna maska silikonowa rozmiar 5, silikonowy worek resuscytacyjny o pojemności 1650ml, rezerwuar tlenu o pojemności 2000 ml, dren O2 o długości 210cm, całość pakowana w sztywne, przezroczyste pudełko w zestawie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie 4 Pakiet 4

Czy Zamawiający zgodzi się, aby łyżka laryngoskopowa w rozmiarze 2 miała długość 100 mm? Jest to jedyna niezgodność w całym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 5 Pakiet 3

Zwracamy się o dopuszczenie jako równoważnego ssaka o parametrach

- wydajność ssaka przepływ 120l/min
- wymiary 45x40x90cm
- waga 24 kg
- w miejsce dwóch pojemników 2l z poliwęglanu, 2 pojemniki 3l z poliwęglanu. Pojemniki nadające się do sterylizacji 120C

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób, który umożliwi udział tylko jednej firmie. Wymiary, waga, pojemność butli są parametrami nieistotnymi z punktu widzenia użyteczności urządzenia, przy czym większy przepływ jest parametrem lepszym od opisanego

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie 6 Pakiet 3

Zwracamy się o dopuszczenie jako równoważnego ssaka o parametrach

- wydajność ssaka przepływ 80l/min
- wymiary 45x35x84cm
- waga 19 kg
- w miejsce dwóch pojemników 2l z poliwęglanu, 2 pojemniki 3l z poliwęglanu. Pojemniki nadające się do sterylizacji 120C

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób, który umożliwi udział tylko jednej firmie. Wymiary, waga, pojemność butli są

parametrami nieistotnymi z punktu widzenia użyteczności urządzenia, przy czym większa różnica w przepływie jest niewielka

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie 7 Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści resuscytator do sterylizacji w temp 121°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści resuscytator sterylizacja 121°C – 20 min albo 134°C – 7 min.

Pytanie 8 Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści niezintegrowany adapter do zastawki PEEP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 9 Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści worek rezerwy o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 10 Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści worek rezerwy o pojemności 1600 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11 Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści tylko 1 maskę w zestawie w rozm. 5?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12 Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści tylko 1 maskę w zestawie w rozm. 4?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13 Pakiet 3

- Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 375 mm x 360 mm x 310 mm (szer. x wys. x gł.), a wraz z podstawą 470 mm x 1000 mm x 550 mm (szer. x wys. x gł.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 14 Pakiet 3

- Czy Zamawiający dopuści ssak o masie max. 23 kg z kompletnym wyposażeniem (11 kg ssak, 12 kg podstawa jezdna)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 15 Pakiet 3

- Czy Zamawiający dopuści ssak z dwoma butlami 5 litrowymi?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16 Pakiet 3

- Czy Zamawiający dopuści ssak z dwoma butlami 3 litrowymi?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 17 Pakiet 4

- Czy Zamawiający będzie wymagał łyżek z zabudowanym światłowodem? Dzięki takiej konstrukcji nie trzeba demontować światłowodu do procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18 Pakiet 4

- Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z zestawem łyżek w rozm. 1-4?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 19 Pakiet 4

- Czy Zamawiający dopuści łyżki Macintosh o długości rozm. 1: 95 mm / rozm. 2: 105 mm / rozm 3: 135 mm / rozm. 4: 155 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 20 Pakiet 4

- Czy Zamawiający dopuści łyżki i rękojeść z możliwością sterylizacji w temperaturze 134°C przez 4-5 minut, przez 2000-2500 °C cykli przy zachowaniu maksymalnej mocy światła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 21 Pakiet 8

- Czy Zamawiający dopuści mankiet wykonany z łatwych do dezynfekcji materiałów, nylonowy mankiet i przezroczysta, wykonana z folii nylonowej osłona?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 22 Pakiet 8

- Czy Zamawiający dopuści z manometrem o śr. 55 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 23 Pakiet 8

- Czy Zamawiający dopuści mankiet nie przeznaczony do prania?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

Beata Szarraniec